




当医院では、患者様のお口に入る水は
除菌水フィルターを通したものを使用しております。

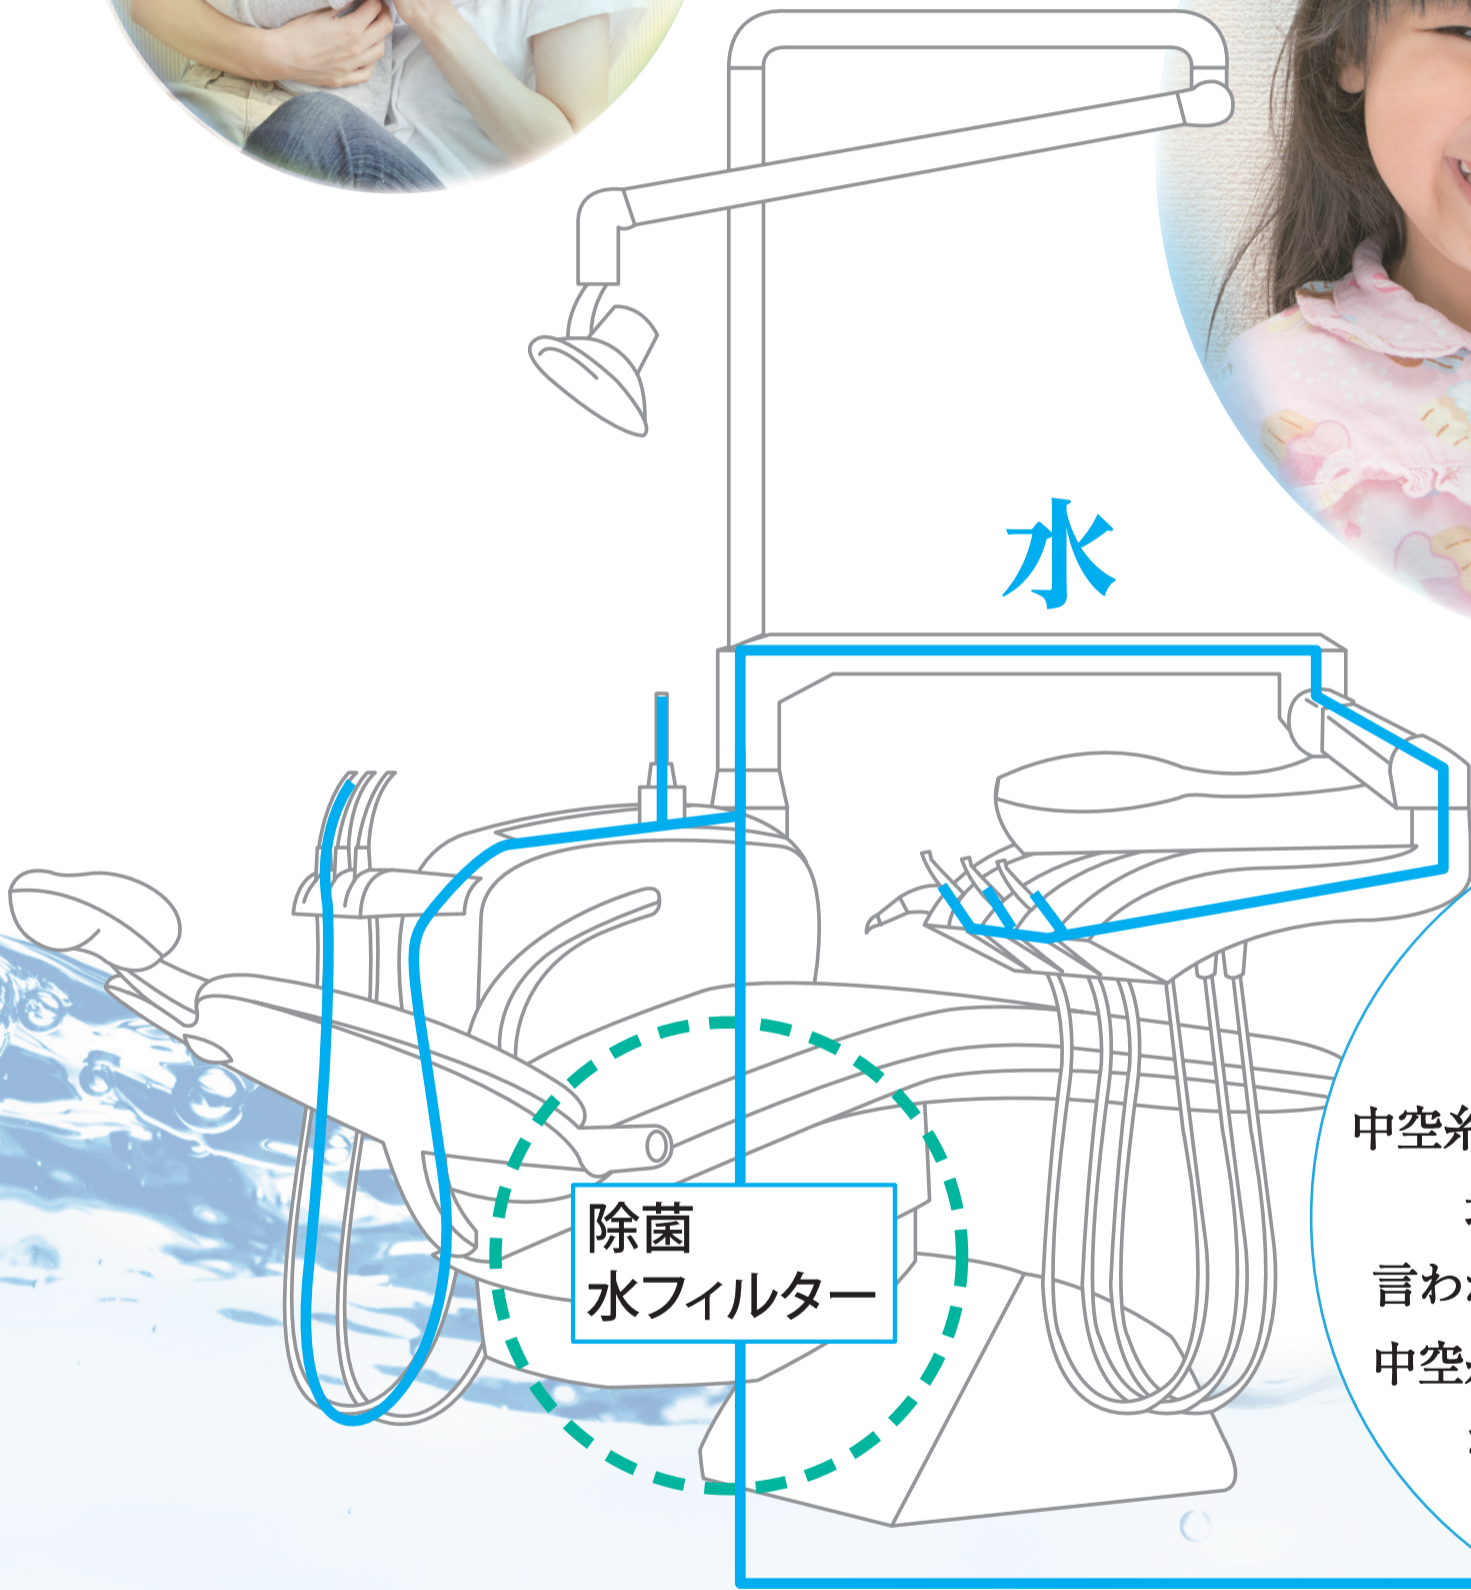

水について

治療台を通る水は
 中空糸膜フィルターを通過しています。
 地球上でもっとも小さいと
 言われている細菌は約 $0.15\mu\text{m}$ 、
 中空糸膜フィルターの径は $0.1\mu\text{m}$
 なので、通り抜けることは
 できません。

前回交換日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> フィルター交換目安 6ヶ月 </div>	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____